


ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ




Основные параметры лазерного излучения

- **E** — энергия излучения,
- **P** — мощность излучения,
- **W** — плотность мощности излучения (интенсивность),
- λ — длина волны излучения,
- **d** — диаметр пучка лазерного излучения,
- $\delta_{\lambda/\lambda}$ — степень монохроматичности,
- **Диаграмма направленности** — угловое распределение энергии или мощности излучения,
- Θ — расходимость лазерного излучения — угол, характеризующий ширину диаграммы направленности,
- Θ_w — энергетическая расходимость лазерного излучения — угол, в которой распространяется заданная доля энергии,

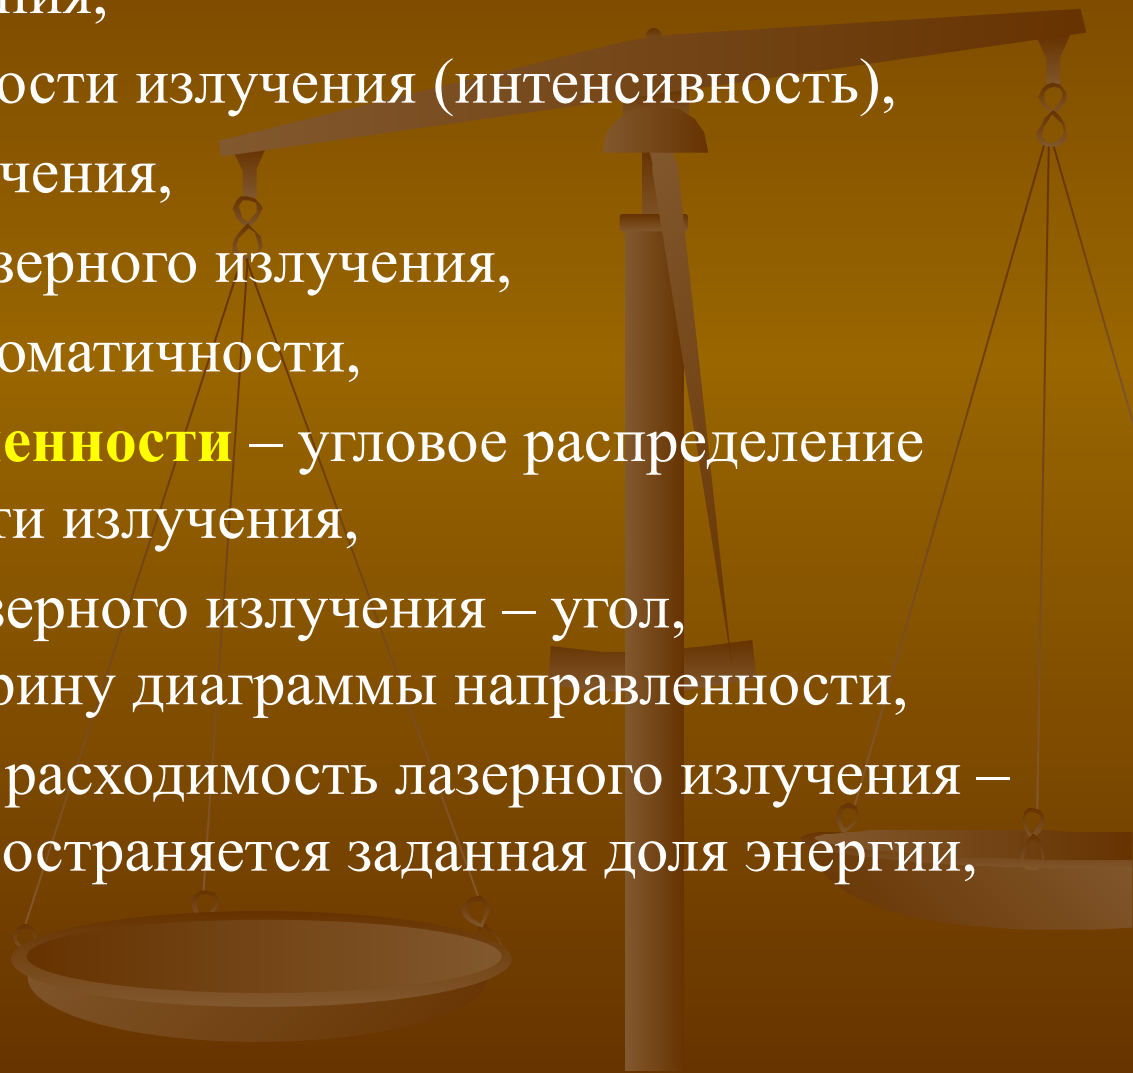


Для импульсных лазеров:

- $E_{\text{и}}$ — энергия в импульсе (для импульсных лазеров),
- $F_{\text{и}}$ — частота следования импульсов,
- q — скважность импульсов — отношение периода следования импульсов к длительности импульса,
- $\tau_{\text{и}}$ — длительность импульса лазерного излучения,
- $\tau_{\text{ф}}$ — длительность фронта импульса — интервал времени, в течение которого мощность излучения нарастает от 0,1 до 0,9 от максимального значения,
- $\tau_{\text{с}}$ — длительность среза импульса — интервал времени, в течение которого мощность излучения спадает от 0,1 до 0,9 от максимального значения.

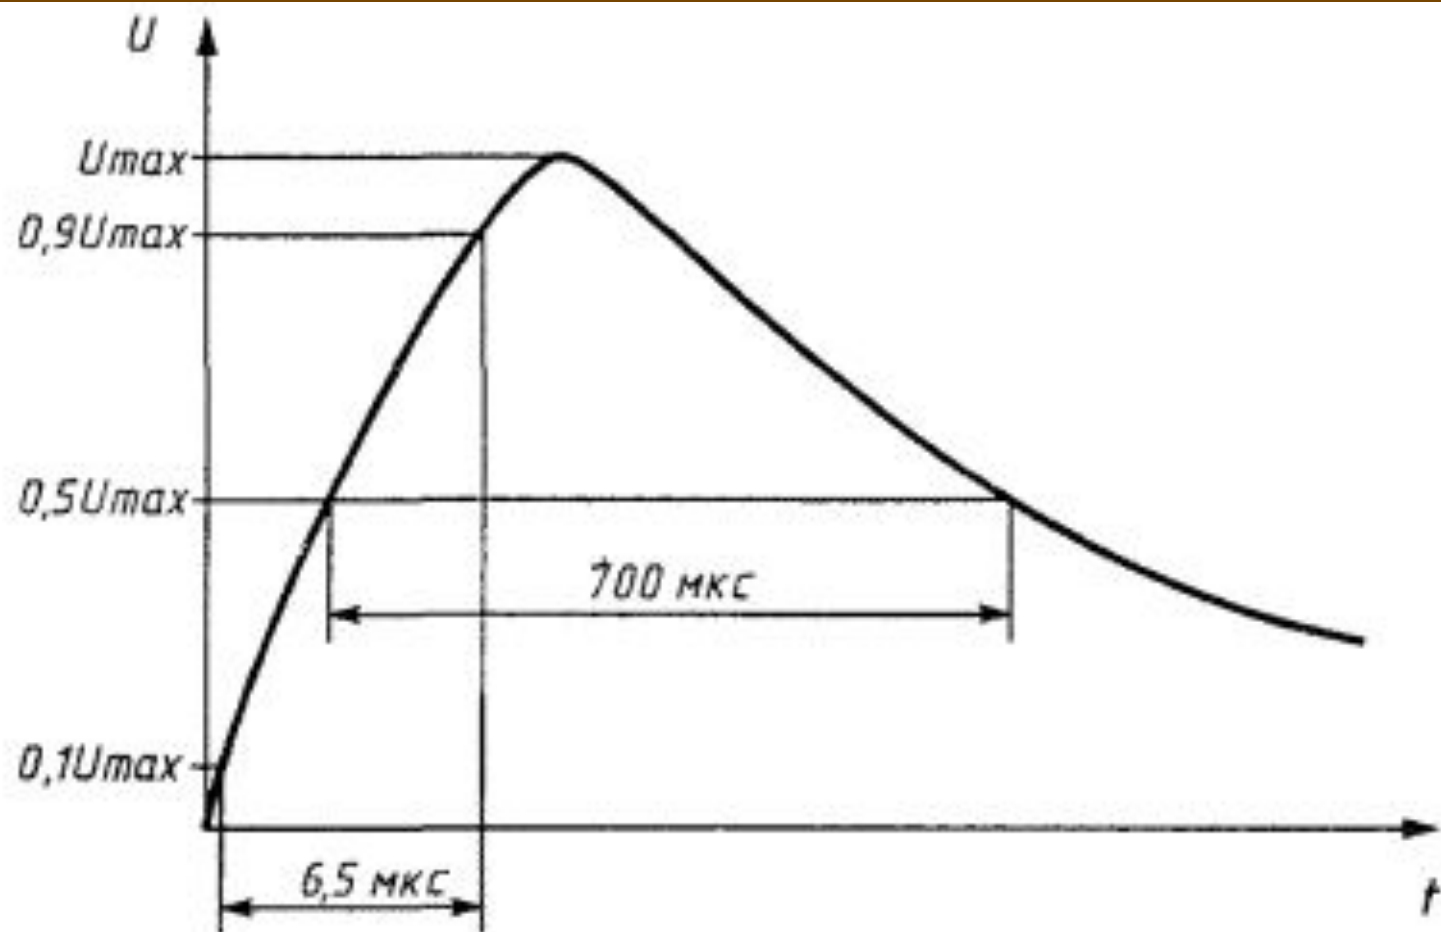

Методы измерений энергии и мощности лазерного излучения

- **Тепловой метод** — основан на использовании тепловой энергии, выделяющейся при поглощении лазерного излучения веществом (калориметрический метод).
- **Фотоэлектрический метод** — основан на использовании фотоэлектрических эффектов в веществе (эмиссия электронов, изменение электропроводности и др.).
- **Метод счета фотонов** — основан на регистрации лазерного излучения путем счета отдельных фотонов.
- **Пондеромоторный метод** — основан на использовании пондеромоторного действия излучения на вещество (передача веществу импульса или момента импульса).

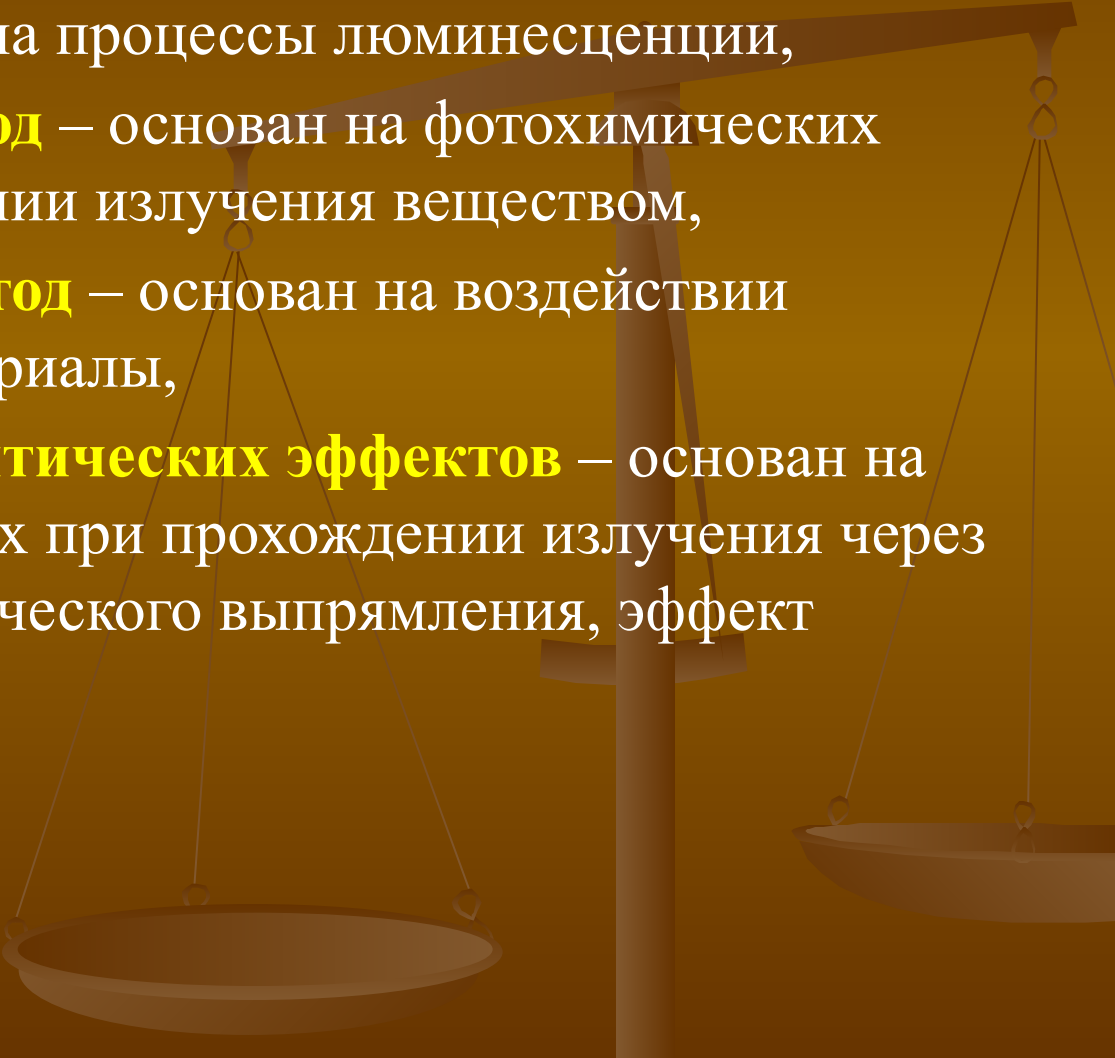- 
- **Люминесцентный метод** — основан на воздействии лазерного излучения на процессы люминесценции,
 - **Фотохимический метод** — основан на фотохимических реакциях при поглощении излучения веществом,
 - **Фотографический метод** — основан на воздействии излучения на фотоматериалы,
 - **Метод нелинейных оптических эффектов** — основан на эффектах, возникающих при прохождении излучения через вещество (эффект оптического выпрямления, эффект поляризации и др.).

Методы измерений расходимости лазерного излучения

- **Метод фокального пятна** — значение расходимости определяется из отношения диаметра пятна изображения в фокальной плоскости линзы, к фокусному расстоянию линзы.
- **Метод двух сечений** — расходимость определяют из отношения разности диаметров двух сечений лазерного луча, к расстоянию между выбранными сечениями.
- **Метод диаграммы направленности** — определяют диаграмму направленности лазерного излучения на основании данных о распределении поля излучения в сечении луча на разных расстояниях от лазера.
- **Автокалибровочный метод** — метод фокального пятна, в котором используется зеркальный клин.

Методы измерений временных параметров и характеристик лазерного излучения

- **Фотоэлектрический метод** — излучение преобразуется фотоэлектрическими преобразователями в электрический сигнал с последующей передачей его на измерительную аппаратуру для измерения параметров электрического импульса, по которым и определяют временные параметры и характеристики лазерного излучения,
- **Тепловой метод** — излучение преобразуют быстродействующими болометрами, пироэлектрическими преобразователями или магнитными пленками с последующей передачей сигнала на измерительную аппаратуру,
- **Метод скоростной фотографии** — для исследования изменяющегося во времени лазерного излучения используют скоростные фотокамеры и фотохронографы.

Методы измерений длины волны, нестабильности длины волны и спектральных характеристик лазерного излучения

- **Метод интерференционной спектрометрии** — используются явления интерференции и интерферометры,
- **Метод призменной спектрометрии** — используются явления дисперсии и призмы,
- **Метод дифракционной спектрометрии** — используются дифракционные явления и дифракционные спектральные приборы,
- **Метод сравнения с эталонным источником излучения** — основан на сравнении длины волны лазерного излучения с длиной волны эталонного источника.

Методы измерений распределения энергии и интенсивности в сечении лазерного луча

- **Метод параллельного анализа** – распределение интенсивности или энергии излучения измеряется одновременно по всему сечению луча,
- **Метод последовательного анализа** - распределение интенсивности или энергии излучения измеряется последовательно по отдельным площадкам сечения луча, например, сканирование лазерного луча по преобразователю,
- **Матричный метод** – при этом методе осуществляется поэлементное дискретное разложение луча при помощи матрицы, состоящего из целой кучи равномерно распределенных измерительных преобразователей.


Методы измерений частоты и нестабильности частоты лазерного излучения

- **Метод сравнения с эталонной частотой** — в качестве эталонных частот используют известные частоты других лазеров или СВЧ-генераторов. В качестве нелинейных элементов используют точечные диоды различных типов, точечный сверхпроводящий переход Джозефсона и др.,
- **Метод межмодовых биений** — регистрируется и анализируется спектр частот биений между отдельными модами лазерного излучения,
- **Метод доплеровского смещения** — используются возникающие в преобразователе излучения низкочастотные электромагнитные биения при сложении исследуемого излучения с отраженным от подвижного зеркала, дающего доплеровский сдвиг частоты.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- **Преобразователь излучения** — предназначенный для преобразования энергии оптического излучения в другие виды энергии,
- **Пондеромоторный преобразователь** — принцип действия основан на пондеромоторном действии оптического излучения, заключающемся в передаче веществу импульса или момента импульса,
- **Тепловой преобразователь** — принцип действия основан на поглощении излучения чувствительным элементом, что приводит к фазовым переходам или к нагреванию этого элемента,

- **Фотоэлектрический преобразователь** — при поглощении излучения чувствительным элементом происходит изменение электрических свойств этого элемента в результате фотоэлектрических явлений,
- **Люминесцентный преобразователь** — основан на изменении параметров оптического излучения люминофором, из которого изготовлен его чувствительный элемент,
- **Фотохимический преобразователь** — в качестве чувствительного элемента используются фотографические материалы или химические актинометры, в которых поглощение излучения приводит к специфической реакции.

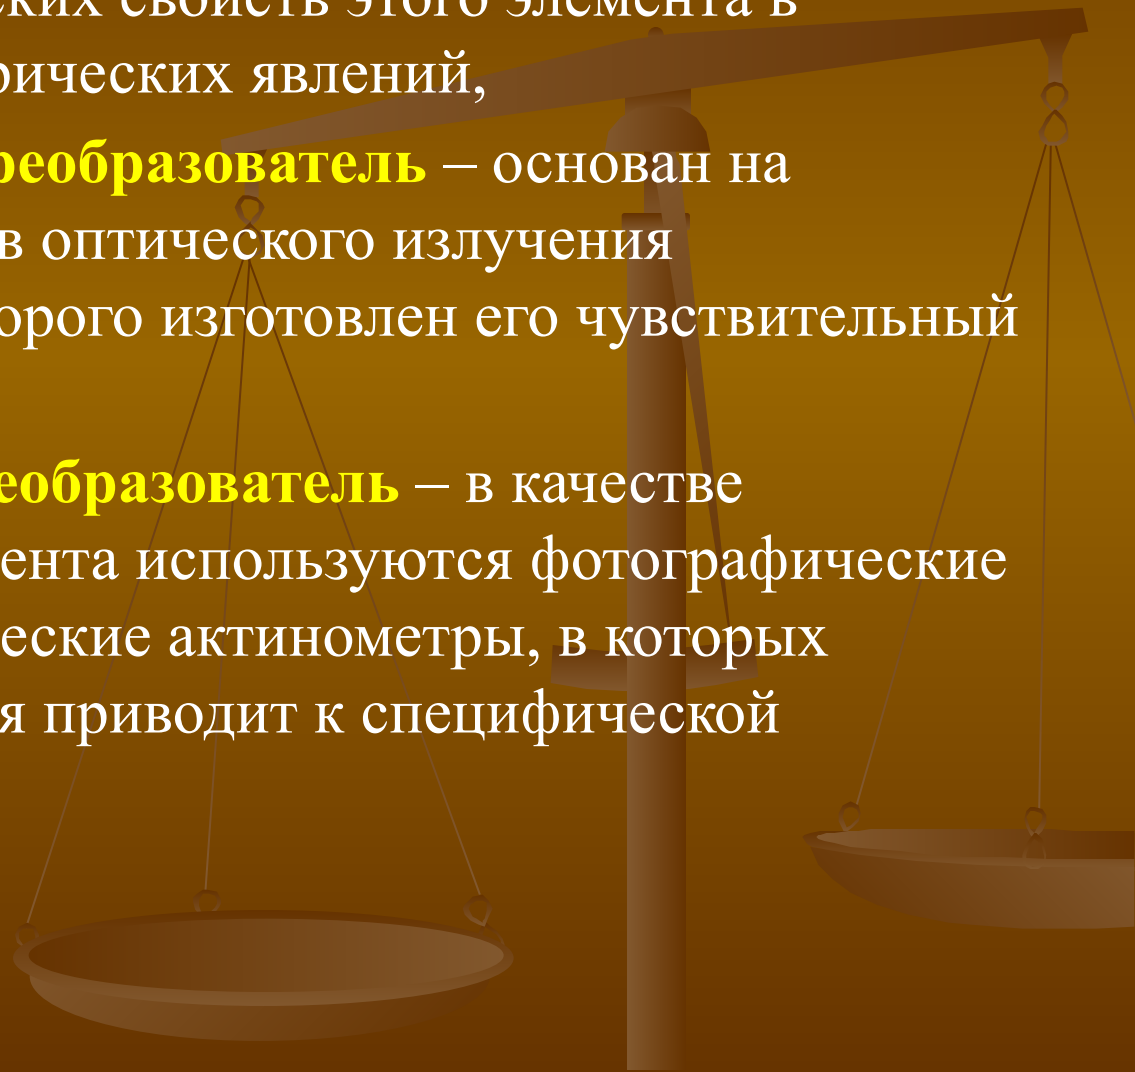

Основные виды тепловых измерительных преобразователей оптического излучения


- **Диэлектрический преобразователь** — система с конденсатором, емкость которого изменяется при поглощения излучения из-за зависимости диэлектрической постоянной вещества от изменений температуры,
- **Пироэлектрический преобразователь** — основан на пироэлектрическом эффекте,
- **Оптико-пневматический преобразователь** — чувствительным элементом является мембрана ячейки с газом, которая изгибается при повышение температуры газа,
- **Термоэлемент** — полупроводниковый или металлический термоэлемент с нормированными метрологическими характеристиками,
- **Термостолбик** — несколько соединенных термоэлементов,

- **Болометр** — действие основано на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента при изменении его температуры вследствие поглощения им лазерного излучения,
- **Сверхпроводящий болометр** — чувствительный элемент изготовлен из сверхпроводника,
- **Магнитная пленка** — ферромагнетик с полосовой доменной структурой, преобразующий энергию импульсного излучения, нагревающего пленку, в распределение ориентации полосовых доменов, основанного на явлении зависимости угла поворота полосовых доменов от температуры нагрева в присутствии внешнего магнитного поля.

Основные виды фотоэлектрических измерительных преобразователей оптического излучения

- **Электровакуумный фотоэлемент** — фотоэлектронный умножитель, фотолампа бегущей волны, фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристор (с нормированными метрологическими характеристиками),
- **Фотоэлектромагнитный преобразователь ФЭМП** — преобразователь излучения с чувствительным элементом из полупроводникового материала, действие которого основано на фотоэлектромагнитном эффекте,

- **Измерительный преобразователь на основе фотонного увлечения** – преобразователь импульсов лазерного излучения, основанный на эффекте увлечения свободных электронов в полупроводниках фотонами,
- **Одноэлементный преобразователь** – преобразователь излучения, имеющий один чувствительный элемент
- **Многоэлементный преобразователь** – преобразователь излучения, имеющий два и более чувствительных элемента,
- **Координатный преобразователь** – выходной сигнал преобразователя зависит от координаты источника излучения.

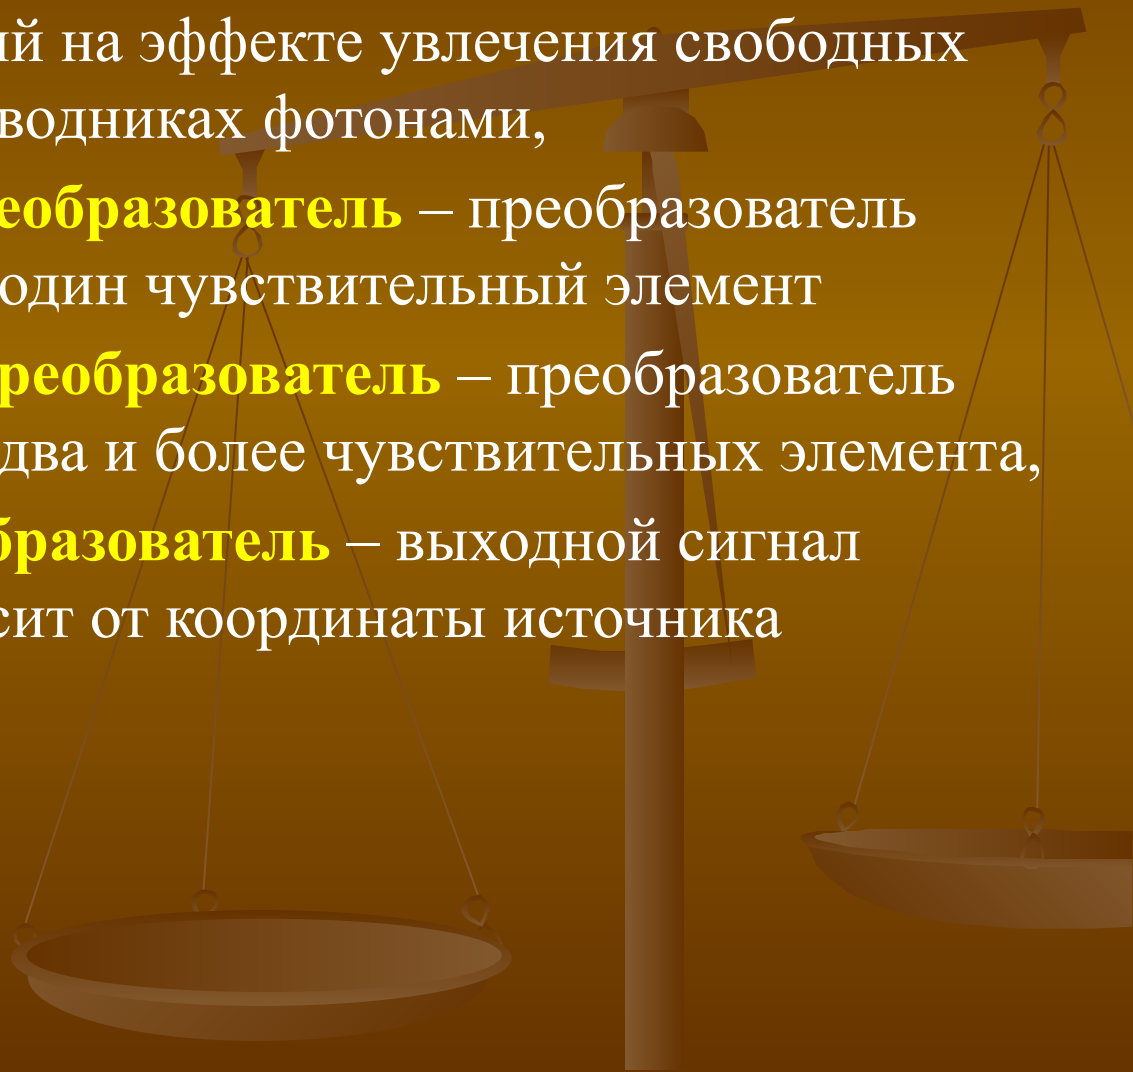

Измерительные приборы и установки

- **Калориметр,**
 - **Фотометр,**
 - **Эллипсометр,**
 - **Фотохронограф** – регистрирует изменяющиеся в пространстве и времени параметры излучения,
 - **Лазеровизор** – предназначен для визуализации лазерного излучения и измерения пространственно-энергетических характеристик,
 - **Дозиметр лазерного излучения** – измеритель параметров лазерного излучения с целью выявления степени опасности воздействия на организм человека, животных и на растения
 - **Голографическая измерительная установка** – предназначена для регистрации голограмм с целью измерения параметров и характеристик лазерного излучения.
- 

Ослабители лазерного излучения

- **Механический ослабитель** — оптико-механическая система, в которой уменьшение мощности излучения осуществляется периодическим прерыванием лазерного луча,
- **Абсорбционный ослабитель** — основан на поглощении излучения веществом в различных агрегатных состояниях,
- **Поляризационный ослабитель** — представляет собой один или несколько поляризаторов, в котором осуществляется регулировка коэффициента пропускания по закону Малюса,
- **Ослабитель с нарушаемым полным внутренним отражением** — система из трех сред с промежуточной средой, имеющей меньший показатель преломления, чем окружающие среды,
- **Дифракционный ослабитель** — основан на свойстве специальной дифракционной решетки,

- **Интерференционный ослабитель** — основан на явлении интерференции излучения на пленке диэлектрика,
 - **Рассеивающий ослабитель** — основан на рассеивании излучения на шероховатостях и частицах,
 - **Жидкокристаллический ослабитель** — основан на рассеивании излучения в жидких кристаллах под действием электрического поля,
 - **Плавно регулируемый ослабитель** — может быть получено любое значение коэффициента ослабления в пределах рабочего диапазона,
 - **Фиксированный ослабитель** — может быть получено одно значение коэффициента ослабления,
 - **Ступенчатый ослабитель** — может быть получен ряд дискретных значений коэффициента ослабления.
- 